

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では来る4月30日に生化学自動分析装置を更新する予定にしておりますが、これに伴い下記項目の検査試薬を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査内容変更項目

コード	検査項目名	検査方法	
		新	旧
0006	TTT(チモール混濁反応)	日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 [和光純薬工業]	日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 [ダイヤ試薬]
0007	ZTT(硫酸亜鉛試験)	日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 [和光純薬工業]	日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 [ダイヤ試薬]
0050	カルシウム(Ca)	O-CPC法 [三菱化学ヤトロン]	O-CPC法 [ダイヤ試薬]
0602	尿蛋白定量	プロモピロガロールレッド・インジウム錯体色素法 [アークレイ]	ピロガロールレッド・モリブデン錯体色素法 [和光純薬工業]

[注] 検体量、基準値等の他の要項には変更ありません。


実施期日

平成16年4月30日(金) 受付日分より




新旧二法の相関


[TTT(チモール混濁反応)]

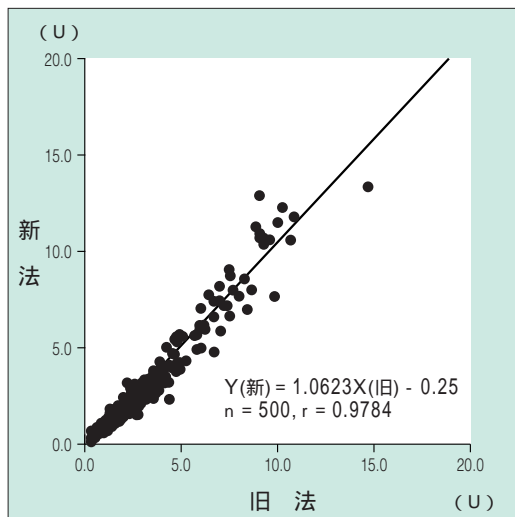


[ZTT(硫酸亜鉛試験)]

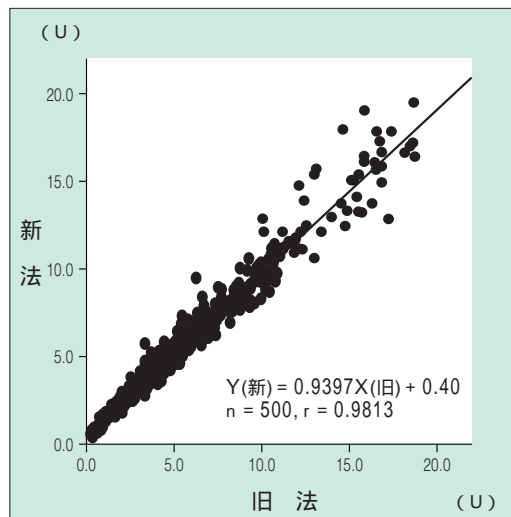

[カルシウム(Ca)]

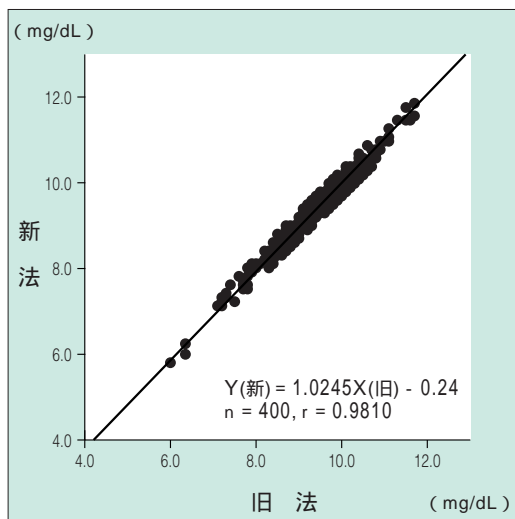

[尿蛋白定量]

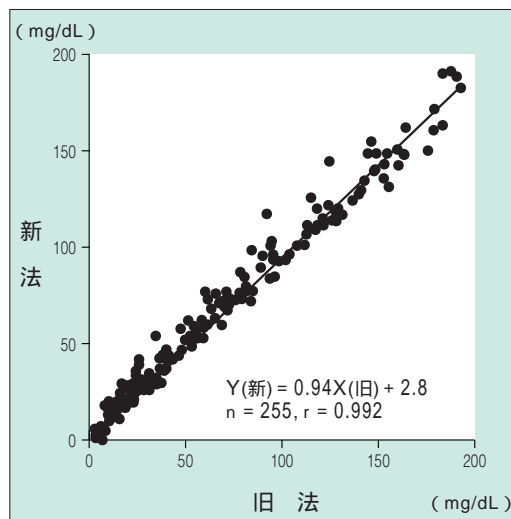

新検査法参考文献

[尿蛋白定量] 小田切隆貢, 他: 機器・試薬 24: 21-26, 2001.