

「腫瘍壊死因子- (TNF-)」検査試薬変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、今般標記項目の現行検査試薬が製造中止されたことに伴い、同一メーカーの代替試薬に変更させていただくことになりましたので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に恐縮ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

変更内容


[5253] 腫瘍壊死因子- (TNF-)

変更箇所	新	旧
検査方法 使用試薬	CLEIA Quanti Glo Human TNF- Immunoassay 2nd Generation [R&D Systems]	CLEIA Quanti Glo Human TNF- Immunoassay [R&D Systems]
検体量	EDTA血漿 0.3mL	EDTA血漿 0.5mL
健常者参考値	1.79 pg/mL 以下	1.50 ~ 12.0pg/mL
報告下限	0.55 pg/mL	0.35 pg/mL

実施期日

平成17年7月1日(金) 受付日分より

新旧二法の相関

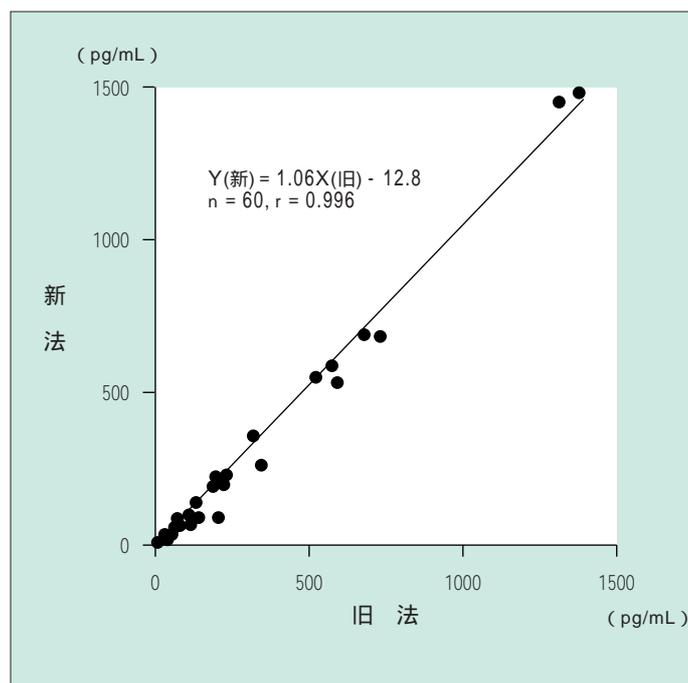

(社内検討データ)