

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、此の度、下記の項目の現行検査試薬が製造中止されたことに伴い、同一メーカーの代替試薬に変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

検査内容変更項目

- [0688] 風疹 IgM
- [2404] パルボウイルス B19 IgM
- [3033] 単純ヘルペス IgM
- [3039] 水痘・帯状ヘルペス定量 IgM
- [3045] サイトメガロ(CMV) IgM
- [3051] 麻疹 IgM
- [3057] ムンプス IgM

変更内容

変更箇所	新	旧
検査方法	EIA 法 [デンカ生研]	EIA 法 [デンカ生研]

判定基準等の要項は従来どおりです。


実施期日

平成 19 年 1 月 4 日(木) 受付日分より



新旧二法の相関


[風疹 IgM]

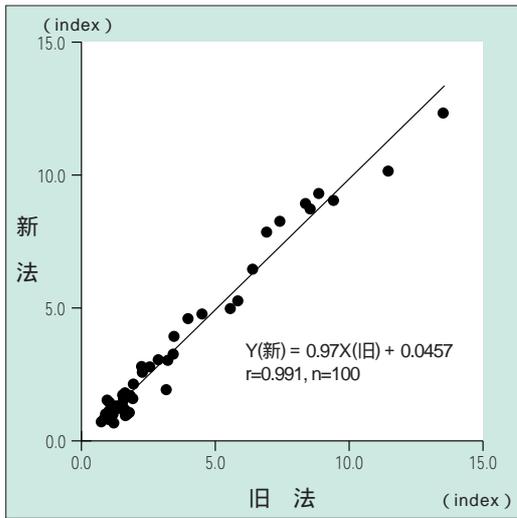

		旧法			計
		(+)	(±)	(-)	
新法	(+)	52	2	0	54
	(±)	0	27	2	29
	(-)	0	1	16	17
計		52	30	18	100

陽性一致率 100.0% (52/52)
陰性一致率 88.9% (16/18)
全体一致率 95.0% (95/100)


[パルボウイルスB19 IgM]

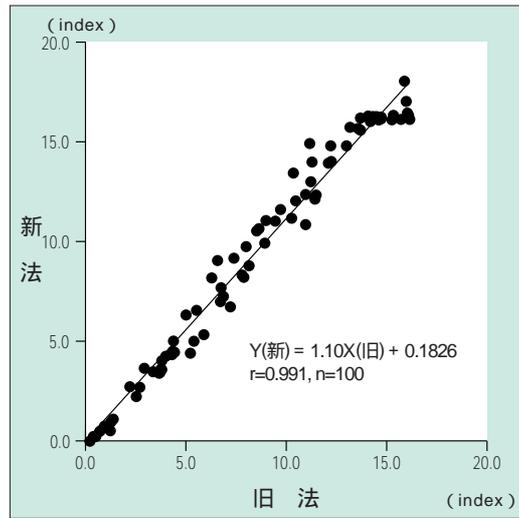

		旧法			計
		(+)	(±)	(-)	
新法	(+)	89	0	0	89
	(±)	0	1	0	1
	(-)	0	1	9	10
計		89	2	9	100

陽性一致率 100.0% (89/89)
陰性一致率 100.0% (9/9)
全体一致率 99.0% (99/100)


[単純ヘルペス IgM]

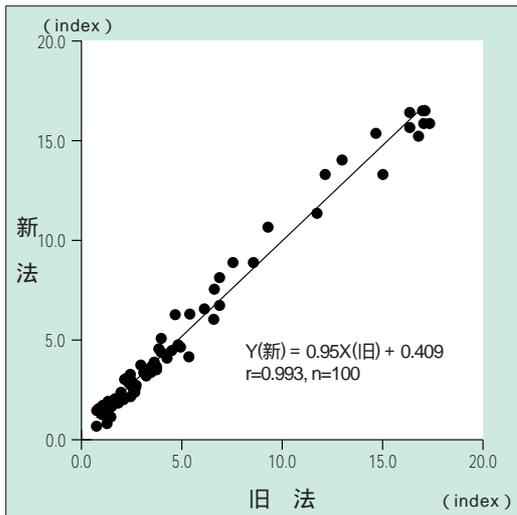

		旧法			計
		(+)	(±)	(-)	
新法	(+)	83	1	0	84
	(±)	1	0	0	1
	(-)	0	0	15	15
計		84	1	15	100

陽性一致率 98.8% (83/84)
陰性一致率 100.0% (15/15)
全体一致率 98.0% (98/100)


[水痘・帯状ヘルペス定量 IgM]

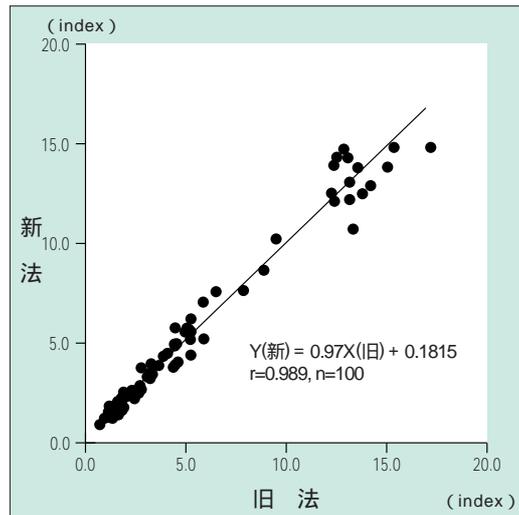

		旧法			計
		(+)	(±)	(-)	
新法	(+)	80	0	0	80
	(±)	3	6	0	9
	(-)	0	1	10	11
計		83	7	10	100

陽性一致率 96.4% (80/83)
陰性一致率 100.0% (10/10)
全体一致率 96.0% (96/100)


[サイトメガロ IgM]

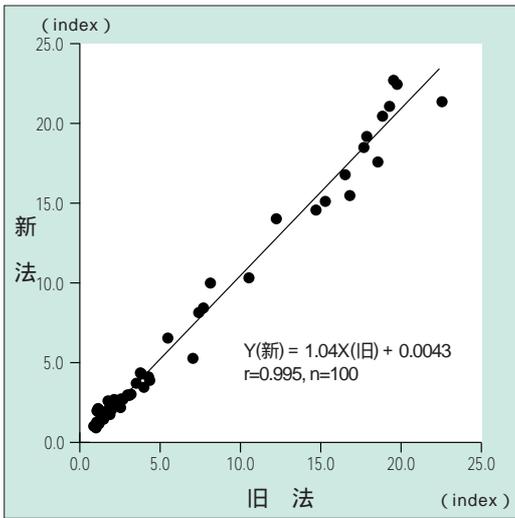

		旧法			計
		(+)	(±)	(-)	
新法	(+)	63	5	0	68
	(±)	3	18	0	21
	(-)	0	1	10	11
計		66	24	10	100

陽性一致率 95.5% (63/66)
陰性一致率 100.0% (10/10)
全体一致率 91.0% (91/100)


[麻疹 IgM]

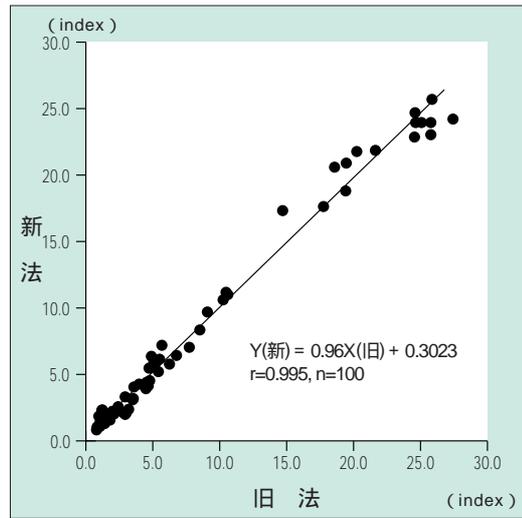

		旧法			計
		(+)	(±)	(-)	
新法	(+)	81	2	0	83
	(±)	3	3	0	6
	(-)	0	1	10	11
計		84	6	10	100

陽性一致率 96.4% (81/84)
陰性一致率 100.0% (10/10)
全体一致率 94.0% (94/100)

[ムンプス IgM]

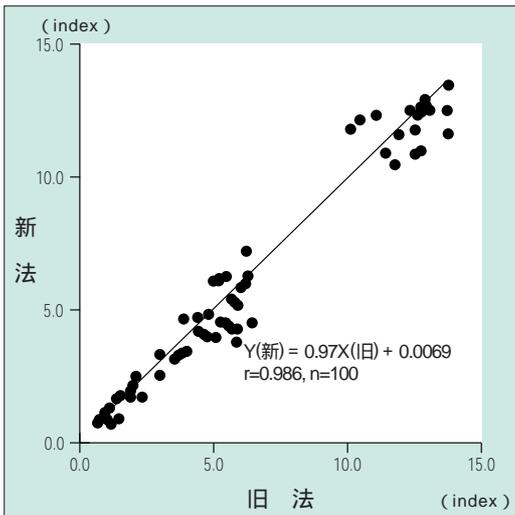

		旧法			計
		(+)	(±)	(-)	
新法	(+)	60	1	0	61
	(±)	2	4	0	6
	(-)	0	0	33	33
計		62	5	33	100

陽性一致率 96.8% (60/62)
陰性一致率 100.0% (33/33)
全体一致率 97.0% (97/100)