

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「HCV-RNA定量《TaqManPCR法》」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目は現行試薬の販売中止に伴い、本年12月2日より同一メーカーが販売する改良試薬に変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目／変更内容


● [08937]HCV-RNA定量《TaqManPCR法》

変更内容	新	旧
検体量	血清 2.1mL*	血清 3.5mL
報告上限値	8.0Log IU/mL 以上	7.8Log IU/mL 以上

※項目コード、検査方法、基準値等の検査要項に変更はございません。

*従来通り、8mL採血管 (TaqManPCR法容器〈血清〉容器番号:79)にてご提出ください。
5mL採血管 (ウイルス遺伝子検査用容器 容器番号:62)での検査も可能ですが、再検査となった場合には再採血をお願いする可能性もありますので、予めご了承ください。

【新旧二法の相関】

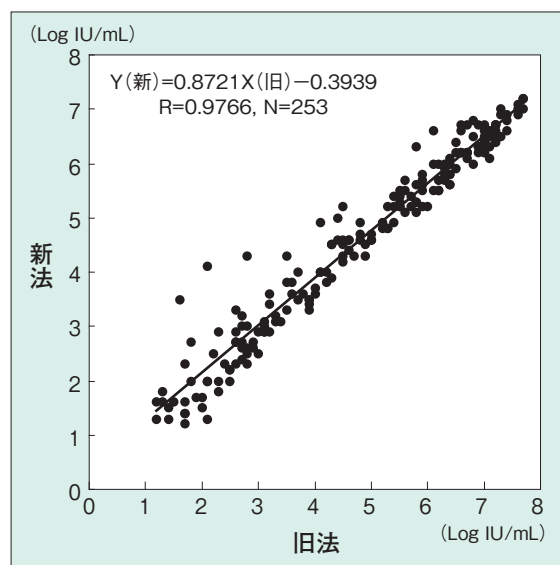

変更期日

- 平成25年12月2日(月)受付日分より