

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「麻疹IgM《EIA》／単純ヘルペスIgM《EIA》」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目の測定試薬を同一メーカーが販売する非特異反応が軽減した改良試薬に変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目／変更内容

- [03051] 麻疹IgM《EIA》
- [03033] 単純ヘルペスIgM《EIA》

変更内容	新	旧
検査方法	EIA [デンカ生研]	EIA [デンカ生研]


※項目コード、基準値等の検査要項に変更はございません。

変更期日

- 平成25年12月2日（月）受付日分より

新旧二法の相関

【麻疹IgM《EIA》】

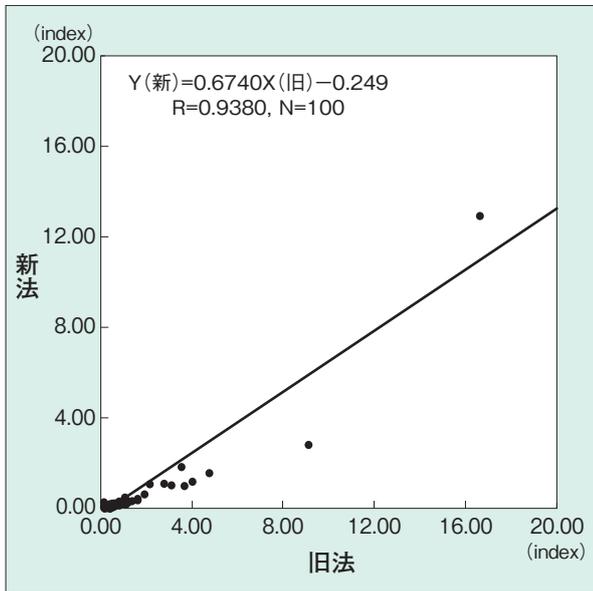

判定一致率

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	5	0	0	5
	±	4	0	0	4
	-	4	13	74	91
計		13	13	74	100


陽性一致率：38.5%

陰性一致率：100%

判定一致率：92.0%

(社内検討データ)

【単純ヘルペスIgM《EIA》】

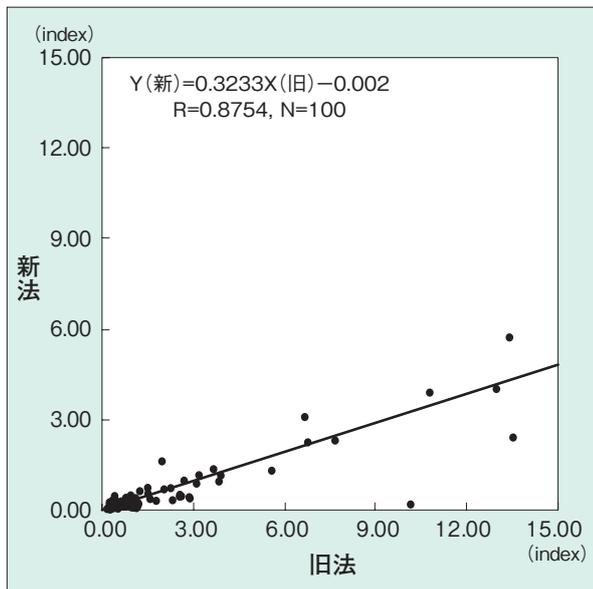

判定一致率

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	12	0	0	12
	±	3	0	0	3
	-	13	23	49	85
計		28	23	49	100

陽性一致率：42.9%

陰性一致率：100%

判定一致率：84.0%

(社内検討データ)