

↓ 当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「組織ポリペプチド抗原 (TPA)」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目は現行試薬の販売中止に伴い、本年9月よりCLIA法による検査試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。なお、本変更に伴い、基準値を試薬メーカー推奨値に変更致します。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目／変更内容

● [01135] 組織ポリペプチド抗原 (TPA)

変更内容	新	旧
項目コード	26551	01135
検査方法	CLIA [協和メデックス]	IRMA (ビーズ固相法) [セティ・メディカルラボ]
基準値	75 U/L 未満	70 U/L 以下
報告上限値	4000 U/L 以上	∞
報告下限値	3 U/L 未満	25 U/L 未満

※検体量等の検査要項に変更はございません。


変更期日

● 平成27年9月1日 (火) 受付日分より




新旧二法の相関

[全体]

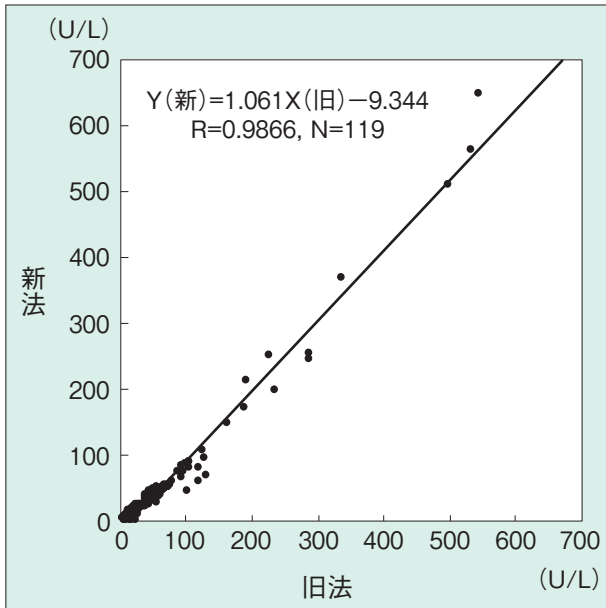

[低値域]

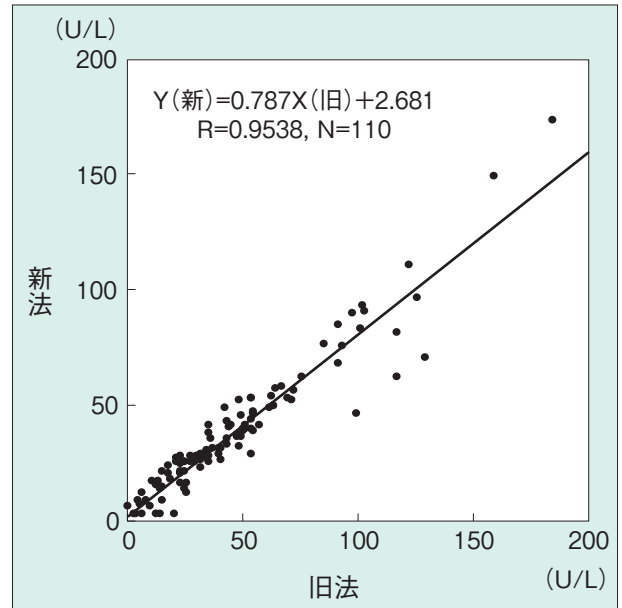

(社内検討データ)