

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「血漿レニン活性 (PRA)」 基準値表記訂正のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて過日、標記項目につきましては現行測定試薬の販売中止に伴い、平成28年1月より検査内容を変更させていただく旨をご案内申し上げます (INFORMATION Vol.15-35)。

この度、新試薬の製造販売元 (ヤマサ醤油) より、基準値の採血条件を「安静時 (座位)」から「座位」に訂正する旨の連絡を受けました。

今般の基準値表記訂正箇所を記載し改めてご案内致しますので、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目 / 変更内容

● [00990] 血漿レニン活性 (PRA)

変更内容	新	旧
項目コード	26580	00990
検体量	EDTA-2Na血漿 0.6mL	EDTA-2Na血漿 1.0mL
検査方法	EIA [ヤマサ醤油]	RIA (ビーズ固相法) [ヤマサ醤油]
基準値	(座位) 0.2~3.9 ng/mL/hr*	(早朝安静時) 0.2~2.7 ng/mL/hr (早朝2時間立位歩行) 0.2~3.9 ng/mL/hr
報告上限値	450 ng/mL/hr 以上	∞
報告下限値	0.2 ng/mL/hr 未満	0.1 ng/mL/hr 未満
報告桁数	小数1位、有効3桁	小数1位、有効5桁

※INFORMATION Vol.15-35にて、採血条件を「安静時(座位)」とご案内致しましたが、「座位」に訂正させていただきます。なお、本基準値は試薬製造販売元のヤマサ醤油社が健常者から採血した検体を用いて算出したものです。


変更期日

● 平成28年1月4日(月)受付日分より




新旧二法の相関

[全体]

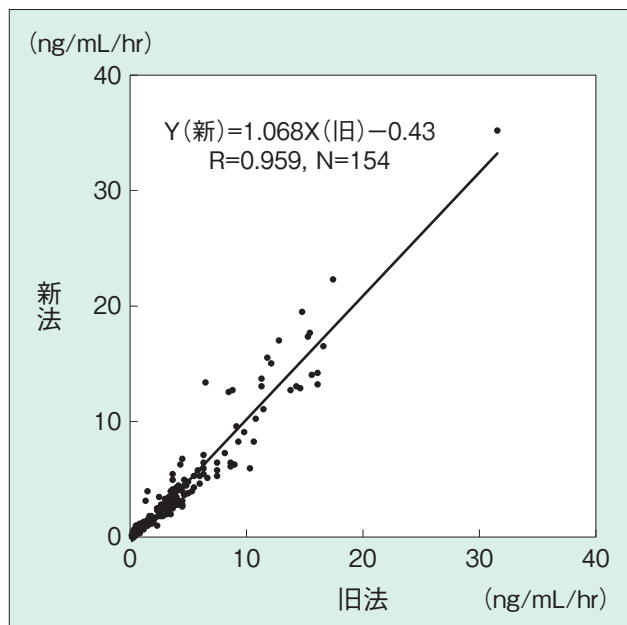

[低値域]

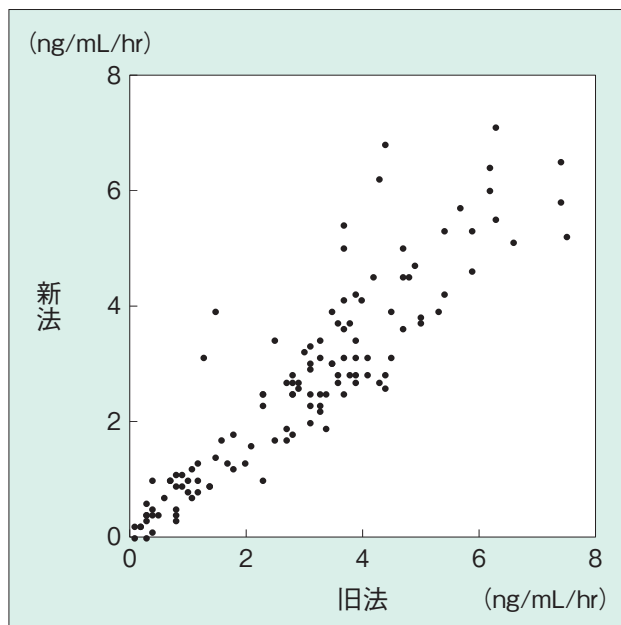

(社内検討データ)